

ADVERTENCIAS

Este producto no está diseñado para fines distintos al uso estándar para transmitir vacío en los microquerátomos MED-LOGICS ML7® y Moria® LSK One, M2 y CB.

El ML8060VS es un producto de un solo uso. No reutilizar. La reutilización puede provocar una succión fallida y contaminación del campo quirúrgico.

Verifique la forma y función del anillo de succión y los componentes de conexión antes de su uso. Si el anillo de succión se deforma, es posible que no se adhiera correctamente al ojo del paciente. Si el anillo de succión o los componentes de conexión no funcionan correctamente, es posible que el sistema de microquerátomo no pueda mantener un vacío constante. Antes de su uso, verifique la integridad del tubo. Si el juego de tubos está dañado o defectuoso, no lo utilice, ya que es posible que no pueda mantener un vacío constante; comuníquese con MED-LOGICS, Inc.® o con un representante autorizado. Si la fecha de caducidad ha pasado, no lo utilices.

Asegúrese de no forzar demasiado el conjunto de tubos de vacío, ya que puede provocar que los tubos o las juntas se fracturen. Este producto está diseñado para un solo uso y, por lo tanto, no debe usarse después de que el tubo se haya estirado de ninguna manera, incluso al retirar el tubo del dispositivo. Si por algún motivo es necesario desconectar el tubo de vacío del anillo de succión, deséchelo y conecte un nuevo juego de tubos de vacío.

© 2020 Copyright MED-LOGICS, Inc. Todos los derechos reservados.
P/N: 900-3896-000

ADVERTENCIAS

Este producto no está diseñado para fines distintos al uso estándar para transmitir vacío en los microquerátomos MED-LOGICS ML7® y Moria® LSK One, M2 y CB.

El ML8060VS es un producto de un solo uso. No reutilizar. La reutilización puede provocar una succión fallida y contaminación del campo quirúrgico.

Verifique la forma y función del anillo de succión y los componentes de conexión antes de su uso. Si el anillo de succión se deforma, es posible que no se adhiera correctamente al ojo del paciente. Si el anillo de succión o los componentes de conexión no funcionan correctamente, es posible que el sistema de microquerátomo no pueda mantener un vacío constante. Antes de su uso, verifique la integridad del tubo. Si el juego de tubos está dañado o defectuoso, no lo utilice, ya que es posible que no pueda mantener un vacío constante; comuníquese con MED-LOGICS, Inc.® o con un representante autorizado. Si la fecha de caducidad ha pasado, no lo utilices.

Asegúrese de no forzar demasiado el conjunto de tubos de vacío, ya que puede provocar que los tubos o las juntas se fracturen. Este producto está diseñado para un solo uso y, por lo tanto, no debe usarse después de que el tubo se haya estirado de ninguna manera, incluso al retirar el tubo del dispositivo. Si por algún motivo es necesario desconectar el tubo de vacío del anillo de succión, deséchelo y conecte un nuevo juego de tubos de vacío.


© 2020 Copyright MED-LOGICS, Inc. Todos los derechos reservados.
P/N: 900-3896-000



ML8060VS

Juego de tubos de vacío para adaptarse al ML7®, Moria® LSK Uno, Microquerátomos M2 y CB.

El juego de tubos de vacío ML8060VS es un dispositivo estéril, desechable y de un solo uso para Úselo con los microquerátomos e MED-LOGICS, Inc.®, ML7 y Moria® LSK ONE, CB y M2. Transmite vacío desde la consola del microquerátomo al anillo de succión, a menudo a través de un mango de succión, para fijarlo al ojo del paciente.

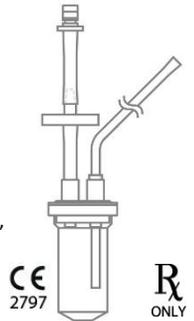

CE
2797

R
ONLY



MED-LOGICS, Inc.®
1627 Enterprise Street, Athens, TX 75751 USA
Tel: +1-949-582-3891/ Correo electrónico: info@mlogics.com



European Representative
E C Rep Ltd,
5 Fitzwilliam Square East, Dublin 2, D02 R744, Ireland
Tel: +353-89 225-1951/ Correo electrónico: info@ecrep.ie



UK Representative
Responsible Person Ltd,
Summit House, 4-5 Mitchell Street, Edinburgh, EH6 7BD, UK
Tel: +44-7543-672-888/ Correo electrónico: info@responsible-person.co.uk


LSK One, CB y M2 son productos de Moria®, y es una marca registrada de Moria Surgical, SA. MED-LOGICS no está afiliado a Moria Surgical, SA



ML8060VS

Juego de tubos de vacío para adaptarse al ML7®, Moria® LSK Uno, Microquerátomos M2 y CB.

El juego de tubos de vacío ML8060VS es un dispositivo estéril, desechable y de un solo uso para Úselo con los microquerátomos e MED-LOGICS, Inc.®, ML7 y Moria® LSK ONE, CB y M2. Transmite vacío desde la consola del microquerátomo al anillo de succión, a menudo a través de un mango de succión, para fijarlo al ojo del paciente.

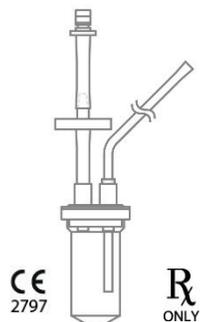

CE
2797

R
ONLY



MED-LOGICS, Inc.®
1627 Enterprise Street, Athens, TX 75751 USA
Tel: +1-949-582-3891/ Correo electrónico: info@mlogics.com



European Representative
E C Rep Ltd,
5 Fitzwilliam Square East, Dublin 2, D02 R744, Ireland
Tel: +353-89 225-1951/ Correo electrónico: info@ecrep.ie



UK Representative
Responsible Person Ltd,
Summit House, 4-5 Mitchell Street, Edinburgh, EH6 7BD, UK
Tel: +44-7543-672-888/ Correo electrónico: info@responsible-person.co.uk


LSK One, CB y M2 son productos de Moria®, y es una marca registrada de Moria Surgical, SA. MED-LOGICS no está afiliado a Moria Surgical, SA

Símbolos utilizados en el etiquetado

	Numero de catalogo
	Numero de lote
	Fabricante
	Representante autorizado en la UE
	Representante autorizado en el Reino Unido
	Marcado CE y Nº Rep. Autorizado
	Consultar Instrucciones de Uso
	Precaución
	No reutilizar
	No utilizar si el paquete está dañado
	Esterilizado con óxido de etileno
	Para uso por, o por orden de, un médico
	Fecha de Fabricación: (AAAA-MM)
	Utilizar por: (AAAA-MM)
	Dispositivo médico
	Identificador único de dispositivo

Instrucciones de uso

1. Retire el juego de tubos de vacío de la bolsa estéril.
2. Conecte el tubo de vacío a la consola del microqueratomo y al mango del anillo de succión como se muestra a continuación:

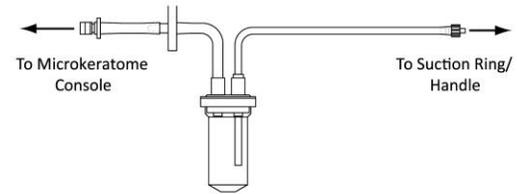

Condiciones de almacenaje

Los juegos de tubos de vacío MED-LOGICS no tienen condiciones especiales de almacenamiento, pero deben almacenarse en condiciones normales de almacén, que incluyen protección contra la humedad, el frío extremo (menos de 5 °C) y el calor excesivo (más de 40 °C).

PRECAUCIONES


La ley federal de EE. UU. restringe la venta y el uso a un médico o por orden de este. La esterilización con EtO se realiza en las bolsas de los tubos. Nunca abra la bolsa del tubo hasta justo antes de usarla. No utilice el tubo si su embalaje está roto. El efecto de esterilización puede debilitarse y el tubo puede quedar no estéril. Este producto está diseñado para que lo utilicen médicos o técnicos experimentados que hayan recibido la instrucción adecuada sobre el uso del sistema de microqueratomo que se está utilizando.

Símbolos utilizados en el etiquetado

	Numero de catalogo
	Numero de lote
	Fabricante
	Representante autorizado en la UE
	Representante autorizado en el Reino Unido
	Marcado CE y Nº Rep. Autorizado
	Consultar Instrucciones de Uso
	Precaución
	No reutilizar
	No utilizar si el paquete está dañado
	Esterilizado con óxido de etileno
	Para uso por, o por orden de, un médico
	Fecha de Fabricación: (AAAA-MM)
	Utilizar por: (AAAA-MM)
	Dispositivo médico
	Identificador único de dispositivo

Instrucciones de uso

1. Retire el juego de tubos de vacío de la bolsa estéril.
2. Conecte el tubo de vacío a la consola del microqueratomo y al mango del anillo de succión como se muestra a continuación:

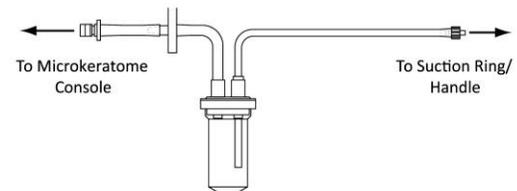

Condiciones de almacenaje

Los juegos de tubos de vacío MED-LOGICS no tienen condiciones especiales de almacenamiento, pero deben almacenarse en condiciones normales de almacén, que incluyen protección contra la humedad, el frío extremo (menos de 5 °C) y el calor excesivo (más de 40 °C).

PRECAUCIONES

La ley federal de EE. UU. restringe la venta y el uso a un médico o por orden de este. La esterilización con EtO se realiza en las bolsas de los tubos. Nunca abra la bolsa del tubo hasta justo antes de usarla. No utilice el tubo si su embalaje está roto. El efecto de esterilización puede debilitarse y el tubo puede quedar no estéril. Este producto está diseñado para que lo utilicen médicos o técnicos experimentados que hayan recibido la instrucción adecuada sobre el uso del sistema de microqueratomo que se está utilizando.